

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі та/або бюджетного призначення предмета закупівлі

(на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (зі змінами))

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС ДК 021:2015:

Аналізатор напівавтоматичний біохімічний, код ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори (НК 024:2023: 56669 Біохімічний автоматичний аналізатор метаболічного профілю IVD (діагностика in vitro) стаціонарний)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги (за особливостями), ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-23-004711-a.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Для надання спеціалізованої ветеринарної допомоги безпритульним тваринам та проведення таким тваринам на якісному рівні хірургічного втручання.


№ п/п	Медико технічні вимоги	
1.	Типи вимірювань	Кінетика, кінцева точка, фіксований час, багато стандартна кінцева точка, двоххвильове вимірювання.
2.	Лінійний діапазон:	0.000-2.500A
3.	Стабільність:	0.005A за 8 годин
4.	Лампа:	Вольфрамова галогенова лампа 6В/10Вт, з функцією збереження лампи
5.	Стандартні оптичні фільтри	340, 405, 500, 546, 578, 620, 670 нм (можливість встановлення інших оптичних фільтрів за вимогою Замовника)
6.	Біхроматичне вимірювання	Повинен мати можливість проводити дослідження на двох довжинах хвиль.
7.	Контроль якості	Прилад повинен мати можливість проводити щоденний контроль якості (2 рівня по кожній методиці) з подальшою статистичною обробкою результатів.
8.	Температурний режим аналізатора:	Пельтьє, кімнатна, 25°C, 30°C, 37°C, ± 0.1°C
9.	Проточна кювета:	Не більше 30 мкл, кварцева,
10.	Межі об'єму аспірації зразка	Не гірше 200-3000 мкл з кроком 50 мкл
11.	Екран:	Не гірше 7" РК- кольоровий екран

12.	Роздільна здатність вимірювань повинна бути не гірша за:	Не гірше 0,001 одиниці оптичної густини (під час індикації даних на дисплеї), 0,0001 одиниці оптичної густини (під час розрахунків)
13.	Друк:	Вмонтований термо або зовнішній паралельний принтер
14.	Інтерфейс зв'язку	2 шт. RS-232, порт для зовнішнього принтера
15.	Пам'ять:	Не менше 160 методик та 500 результатів тестів. Звіти по пацієнтам, тестам.
16.	Форми звітів	Можливість звітів: по пацієнтам, результатам та інше
17.	Вимоги до електроживлення:	АС 90-250В, 50-60 Гц
18.	Споживча потужність	Не більше 150 Вт

Обґрунтування вартості закупівлі:

Відповідно до статті 4 *Закону України «Про публічні закупівлі»* з урахуванням пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» для забезпечення наявної потреби Замовника, планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до Річного плану закупівель (змін до річного плану закупівель). *Джерело фінансування закупівлі:* місцевий бюджет – 133 000,00 грн. з ПДВ. Очікувана вартість закупівлі – 133 000,00 грн. з ПДВ. Кількість – 1 штука. Очікувана вартість визначена на підставі отриманих комерційних пропозицій.

Уповноважена особа з
публічних закупівель

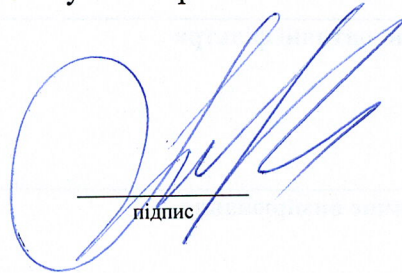

підпис

Наталя ПІВНЕВА